





Installatie instructie NP9

Inhoud van de verzenddoos:

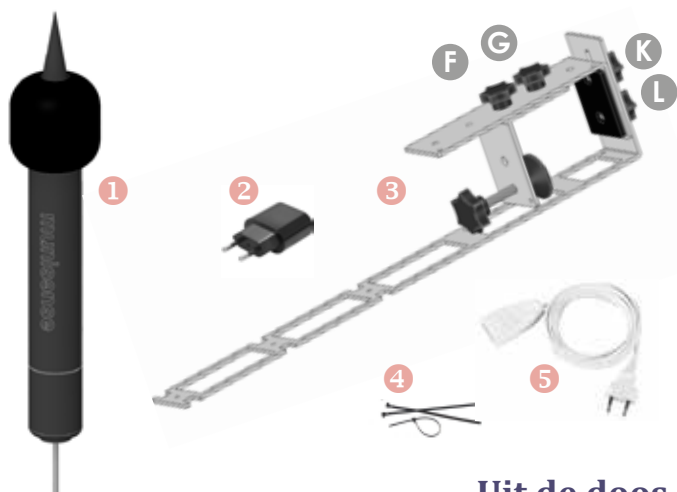

- 1 Model NP9, compacte geluidsmeter met stroomkabel^{*)} en 2 adapter in kartonnen transport koker
- Doos met daarin
- 3 de vensterbank bevestigingsset bestaande uit:
 - bevestigingsbeugel met schroefknop
 - hoekbeugel (met gaten A t/m E)
 - 2 schroefknoppen F en G
 - Geluidsmeterbeugel met 2 schroefknoppen K en L
 - Valbeveiligingsdraad (gemonteerd aan de beugel)
- 4 Een aantal herbruikbare tiewraps
- 5 5 meter lang verlengsnoer - in het geval het stopcontact verder bij uw raam verwijderd is.

Uit de doos - de eerste stap

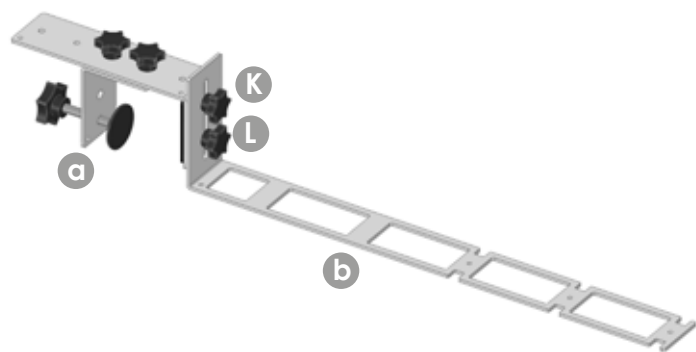


In verband met een zo compact mogelijke verzending zijn de klembeugel a en de geluidsmeterbeugel b omgekeerd aan elkaar vastgemaakt.


Dus voordat u verder gaat: Draai de twee schroefknoppen K en L van de geluidsmeterbeugel b los. Draai deze 180° om zodat deze er uitziet zoals op de afbeelding hiernaast.

Bevestig dan beugel b weer aan klembeugel a met dezelfde twee schroefknoppen K en L.
De valbeveiliging, het nylon touwtje, niet losmaken.

Dikte en diepte vensterdorpel



Dikte dorpel R	→	Gebruik opening
0-50 mm	→	D en E
35-85 mm	→	C en D
70-120 mm	→	B en C
105-155 mm	→	A en B

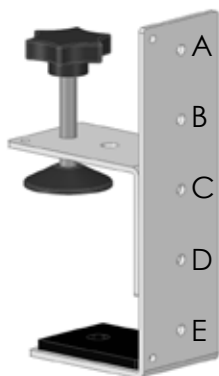


Voor goede bevestiging van de NP9 geluidsmeter is het belangrijk dat u de dikte van uw vensterbank R opmeet én de diepte S van de voorzijde van de vensterbank tot de gevel.

Schroef het klemgedeelte vast met de twee schroefknoppen F en G in de volgens de tabel aangegeven openingen.

De schroefknoppen K en L van de geluidsmeterbeugel b kunt u op de gemeten afstand S, de diepte van uw vensterbank, vastdraaien zodat de beugel zo dichtbij als mogelijk tegen uw buitengevel zal hangen.

Bevestigen geluidsmeter en voedingskabel

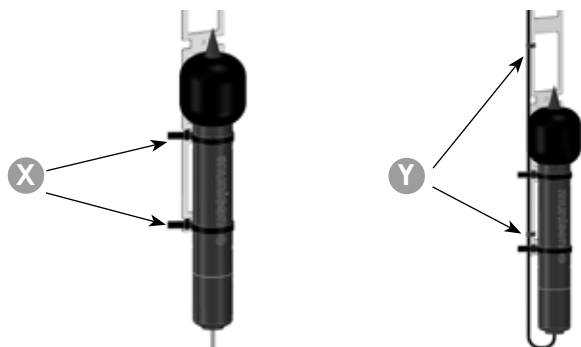

X Bevestig de NP9 geluidsmeter met twee bijgeleverde hersluitbare kabelbinders aan de beugel, waarbij deze kabelbindertjes precies in de inkepingen vallen.

Y Bevestig de voedingskabel^{*)} met de andere twee kabelbinders aan de beugel, zodat de kabel niet los hangt en tegen de geluidsmeter aan kan tikken.

^{*)} Let op: deze USB-C kabel mag **niet** worden verlengd.



Bijna klaar


Stroomvoorziening:

Steek de stekker van de voedingskabel in het stopcontact voor de gehele meetperiode(!). Gebruik eventueel het verlengsnoer **5**. Leg het geheel in de buurt van het raam.

Ontvangen email:

Volg nu de stappen in de uitnodigingslink die u per e-mail hebt ontvangen, voor het activatieproces. Pas daarna kunt u de geluidsmeter ophangen.

Ophangen geluidsmeter

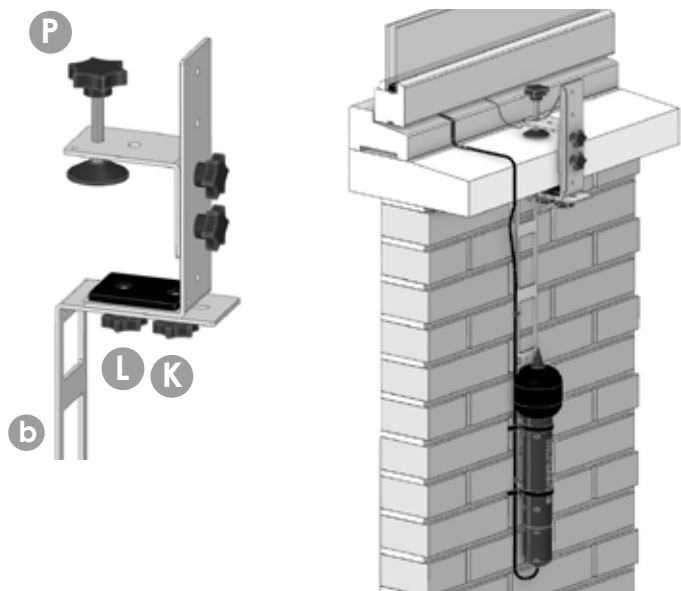

Eindresultaat

Bevestig de valbevestigingsdraad aan een vast object bij het raam, bijv. een verwarmingsbuis. Draai het uiteinde van de draad met daaraan het haakje een paar maal om het object en maak het haakje vast aan de draad. Controleer of de valbeveiliging vast zit.

Bevestig de bevestigingsbeugel met de geluidsmeter buiten aan uw vensterbank. Draai met de klemknop P de beugel zeer stevig vast aan uw vensterbank.

BELANGRIJK: Om juiste metingen te doen, moet de geluidsmeterbeugel dicht tegen de buitengevel hangen!

Draai hiervoor de schroefknoppen K en L eventueel nog iets los zodat u de geluidsmeterbeugel b tegen de gevel aan kunt drukken. Schroef hierna de knoppen weer stevig vast.

U kunt hierna het raam sluiten. De platte voedingskabel en de valbeveiligingsdraad lopen onder uw raam door.


Maak de foto's van de geïnstalleerde sensor en upload deze zodat u het activatieproces kunt afronden.

Na afloop van de meetperiode

Draai de klemknop van de bevestigingsbeugel los en verwijder deze met de NP9 geluidsmeter in zijn geheel van uw vensterbank. Maak de valbeveiligingsdraad los van het door u gekozen bevestigingspunt. Haal de stekker

uit het stopcontact. Maak de kabelbinders los van de beugel: doorknippen is niet nodig. Schuif de geluidsmeter, met de voedingskabel en de adapter weer in de bruine transportkoker en dek af met het beschermingsschuim.

Verpakken voor transport

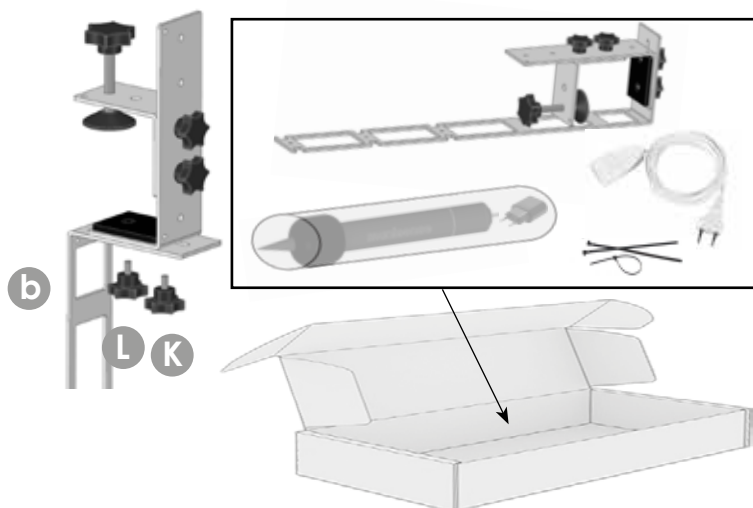

De bevestigingsbeugels moeten weer omgekeerd aan elkaar worden gemonteerd.

Draai hiervoor de twee schroefknopjes (K en L) van de geluidsmeterbeugel b los. Draai de beugel 180° om en zet deze beugel weer vast aan de klembeugel a met de twee schroefknopjes.

Plaats alle onderdelen weer terug in de verzenddoos:

- de bruine lange doos met daarin de bevestigingsbeugel met de valbeveiliging, de knoppen, het 5 meter verlengsnoer en de herbruikbare kabelbinders.
- de koker met daarin de NP9 geluidsmeter met voedingskabel en adapter.